

<b>In te vullen door de behandelende arts/verpleegkundig specialist</b>	
<b>stap 1 - indicatiestelling voor compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie:</b>	
<input type="checkbox"/> lymfoedeem	<input type="checkbox"/> post-traumatisch oedeem
<input type="checkbox"/> lipoeedeem	<input type="checkbox"/> verharde littekens/fibrose
<b>stap 2 - aanduiding te behandelen lichaamsdeel:</b>	
<input type="checkbox"/> mid-line	<input type="checkbox"/> bovenbenen <input type="checkbox"/> onderbenen
<b>stap 3 - compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten.</b>	
<b>stap 4 - behandelduur:</b> <input type="checkbox"/> kortdurig (< 3 weken) <input type="checkbox"/> langdurig (> 3 weken) <input type="checkbox"/> permanent	
<b>stap 5 - draagadvies:</b>	
<input type="checkbox"/> dag en nacht <input type="checkbox"/> dag of nacht <input type="checkbox"/> anders nl.: (hieronder vermelden)	
<b>stap 6 - naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:</b>	
specialisme:	AGB-code:
naam praktijk/instelling, adres en plaats:	
<b>compressiehulpmiddel bestemd voor:</b>	
naam patiënt:	
geboortedatum:	
adres:	huisnummer:
postcode + woonplaats:	
verzekeraar:	
burger service nummer:	
<b>besteld door:</b>	
naam praktijk/instelling:	
contactpersoon:	
afleveradres:	huisnummer:
postcode + woonplaats:	
telefoonnummer:	

**U bestelt eenvoudig: per e-mail: info@varodem.nl of per fax (gratis!): 0800 0202332.**

Verbandmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke richtlijnen apothekers. Voor foutieve maatopgave is de besteller verantwoordelijk.

Datum: - -

**Curetex®**

**Recept- en bestelformulier Curetex® onderlichaam bandages**

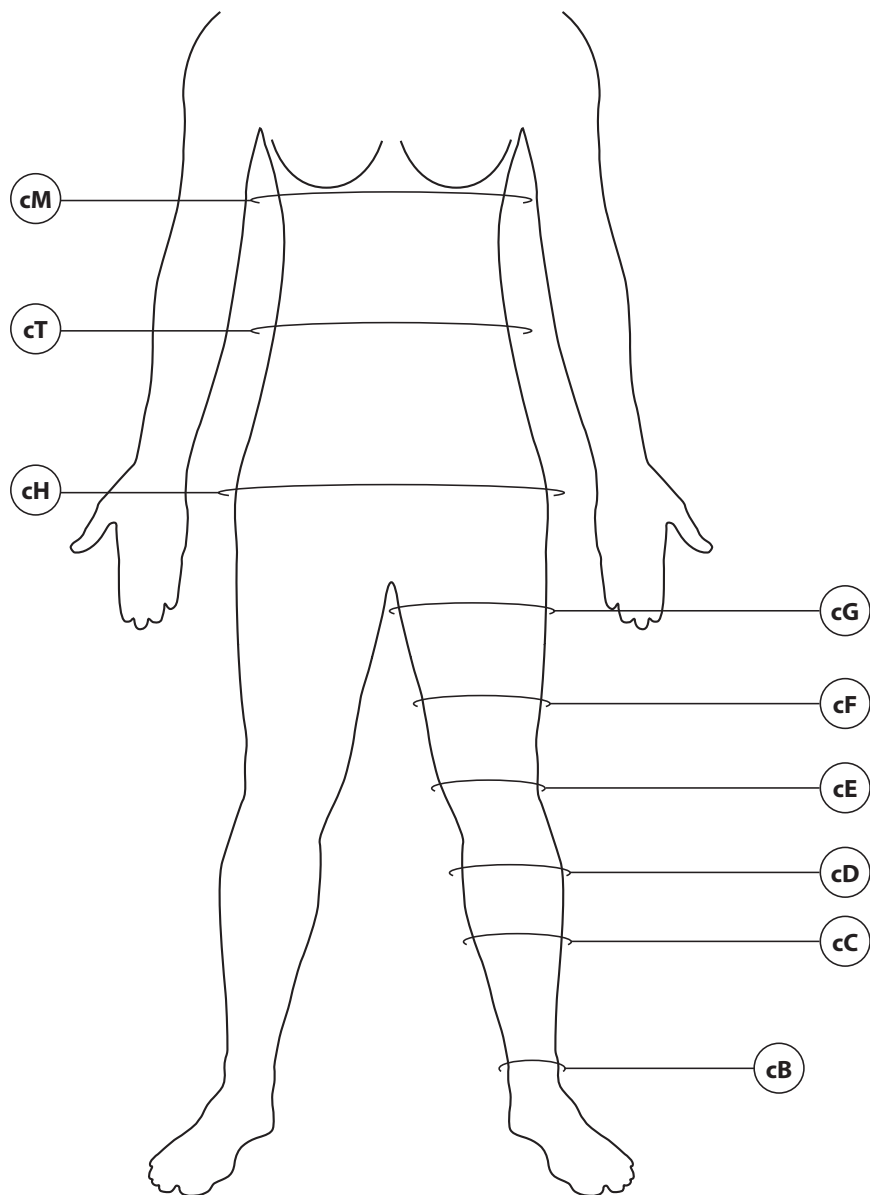
Stap 1: Modelkeuze			Stap 2: Aantal/ kleur		
<b>FT</b>	<input type="checkbox"/> CRTX106 (gesloten kruis)	<input type="checkbox"/> CRTX1112 (open kruis)	<input type="checkbox"/> CRTXH99 (heren, gesloten kruis)	aantal	
<b>CT</b>	<input type="checkbox"/> CRTX133 (gesloten kruis)	<input type="checkbox"/> CRTX113 (open kruis)	<input type="checkbox"/> CRTXH99A (heren, gesloten kruis)	kleur	<input type="checkbox"/> beige
<b>BT</b>	<input type="checkbox"/> CRTX133A (gesloten kruis)	<input type="checkbox"/> CRTX536 (open kruis)			<input type="checkbox"/> zwart
<b>FT hoog</b>	<input type="checkbox"/> CRTX109 (gesloten kruis)	<input type="checkbox"/> CRTX111 (open kruis)	<input type="checkbox"/> CRTX97 (heren, gesloten kruis)		<input type="checkbox"/> wit
<b>CT hoog</b>		<input type="checkbox"/> CRTX1103 (open kruis)			

Stap 3: Maten	
<p><b>omvangmaten in cm</b></p>	<p><b>lengtematen in cm</b></p> <p>lM .....                      lT .....                      lH .....                      lG .....                      lF .....                      lE .....                      lD .....                      lC .....                      lB .....</p> <p>rechts   links</p> <p><i>*Gelieve alle benodigde maten voor het door u gekozen model in te vullen.</i></p>
<p><b>lK1T:</b> lengte kruis tot taille voorzijde .....</p> <p><b>lK2T:</b> lengte achterzijde .....</p>	

Stap 6: Opties			
<input type="checkbox"/> siliconenband op: <input type="checkbox"/> taille <b>OF</b> <input type="checkbox"/> pijpjes	<b>sluiting:</b>	Standaard is een broek zonder sluiting	
<input type="checkbox"/> katoenen voering op: <input type="checkbox"/> buik <b>OF</b> <input type="checkbox"/> kruis			<input type="checkbox"/> rits
<input type="checkbox"/> bretels			<input type="checkbox"/> haak- /oog

**Op de achterkant van dit formulier staat belangrijke informatie voor uw bestelling.**

## Meetpunten


**VARODEM®**

The Compression Company

**Kijk voor meer informatie over de Curetex® producten op:**  
[www.varodem.nl/curetex](http://www.varodem.nl/curetex).

**U bestelt eenvoudig:**  
**Per e-mail: [info@varodem.nl](mailto:info@varodem.nl)**  
**Per fax (gratis!): 0800 0202332**

*Verbandmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke richtlijnen apothekers. Voor foutieve maatopgave is de besteller verantwoordelijk.*